

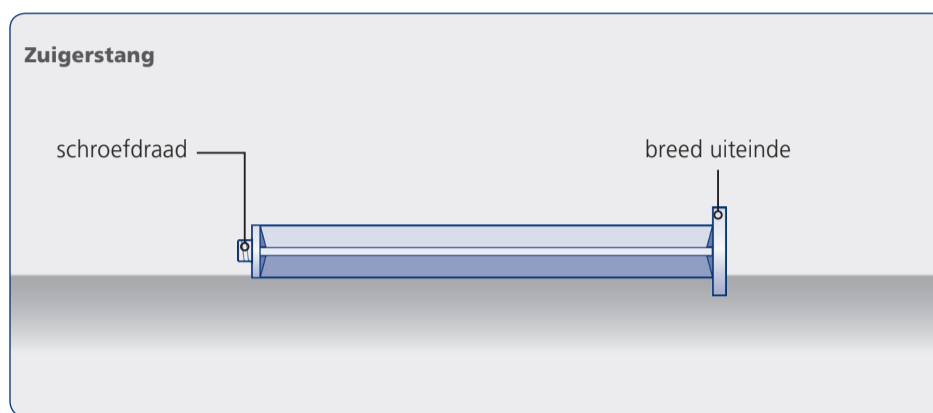
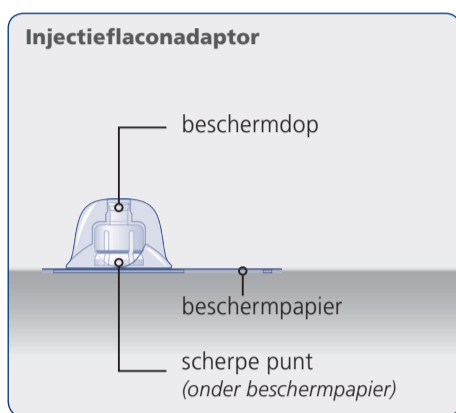


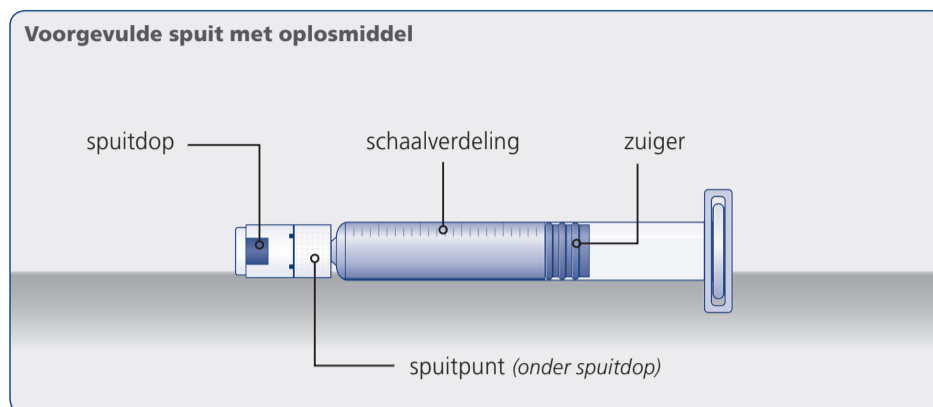


Richtlijnen voor het gebruik van NovoEight®

Overzicht

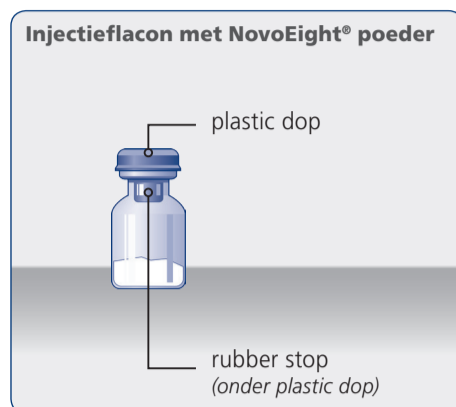


1 Klaarmaken van de injectieflacon en de spuit

- Pak het aantal NovoEight® verpakkingen dat nodig is.
- Controleer de houdbaarheidsdatum.
- Controleer de naam, sterkte en kleur van de verpakking en verzeker u ervan dat de verpakking het juiste geneesmiddel bevat.
- Was uw handen en laat ze goed drogen aan de lucht of gebruik een schone handdoek.
- Haal de injectieflacon, de injectieflaconadapter en de voorgevulde spuit uit de doos. **Laat de zuigerstang onaangeraakt in de doos.**
- Laat de injectieflacon en de voorgevulde spuit op kamertemperatuur komen. U kunt dit doen door deze in uw handen te houden tot ze zo warm aanvoelen als uw handen.
- Gebruik geen andere manier om de injectieflacon en de voorgevulde spuit op te warmen.

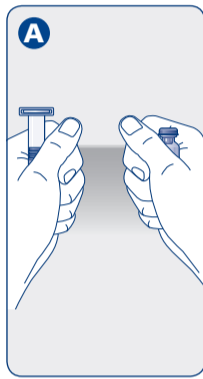


2 Bevestig de injectieflaconadapter


- Verwijder het bescherm papier van de injectieflaconadapter.
- Gebruik de injectieflaconadapter niet als het bescherm papier niet helemaal dichtgeplakt is of als het gescheurd is.
- Haal de injectieflaconadapter niet uit de bescherm dop met uw vingers. Als u de scherpe punt op de injectieflaconadapter aanraakt, kunnen ziektekiemen van uw vingers worden overgedragen.

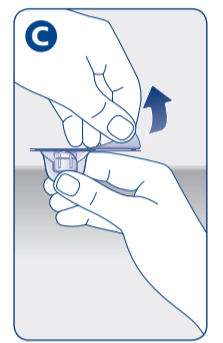


- Verwijder de plastic dop van de injectieflacon. Als de plastic dop los zit of ontbreekt, gebruik de injectieflacon dan niet.
- Reinig de rubber stop met een steriel alcoholdoekje en laat deze voor gebruik enkele seconden drogen om er zeker van te zijn dat deze zo ziektekiemvrij mogelijk is.
- Raak de rubber stop niet aan met uw vingers omdat dit ziektekiemen kan overdragen.

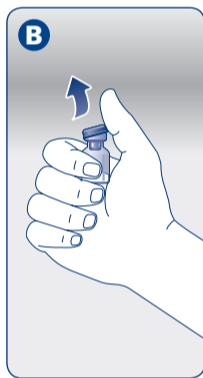

- Plaats de injectieflacon op een vlakke en stevige ondergrond.
- Draai de bescherm dop om en druk de injectieflaconadapter op de injectieflacon.
- Haal de injectieflaconadapter niet meer van de injectieflacon zodra deze bevestigd is.




- Knijp zachtjes in de bescherm dop met uw duim en wijsvinger zoals op de tekening weergegeven is.
- Verwijder de bescherm dop van de injectieflaconadapter.
- Haal de injectieflaconadapter niet van de injectieflacon wanneer u de bescherm dop verwijdert.

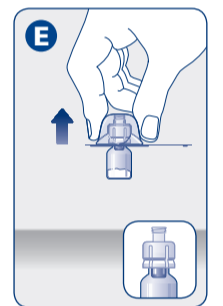


3 Bevestig de zuigerstang en de spuit


- Pak de zuigerstang bij het brede uiteinde vast en neem deze uit de doos.
- Raak de zijkanten en de schroefdraad van de zuigerstang niet aan. Als u de zijkanten of de schroefdraad aanraakt, kunnen ziektekiemen van uw vingers worden overgedragen.
- Bevestig onmiddellijk de zuigerstang in de spuit door deze met de klok mee in de zuiger in de voorgevulde spuit te draaien totdat u weerstand voelt.



- Verwijder de dop van de voorgevulde spuit door deze naar beneden te buigen totdat deze afbreekt bij de perforatierand.
- Raak de punt van de spuit onder de spuitdop niet aan. Als u de punt van de spuit aanraakt, kunnen ziektekiemen van uw vingers worden overgedragen.
- Als de dop van de spuit loszit of ontbreekt, gebruik de voorgevulde spuit dan niet.




- Schroef de voorgevulde spuit stevig op de injectieflaconadapter totdat u weerstand voelt.




4 Meng het poeder met het oplosmiddel

- Houd de voorgevulde spuit een beetje schuin, met de injectieflacon naar beneden gericht.
- Druk de zuigerstang in om al het oplosmiddel in de injectieflacon te spuiten.




- Houd de zuigerstang volledig ingedrukt.
- Draai de spuit met de injectieflacon erop ondersteboven.
- Druk niet meer op de zuigerstang en laat deze vanzelf langzaam terugglijden terwijl de spuit zich vult met de gemengde oplossing.
- Trek de zuigerstang een beetje naar beneden om de gemengde oplossing in de spuit te zuigen.
- Als u maar een deel van de volledige injectieflacon nodig heeft, gebruik dan de schaalverdeling op de spuit om te zien hoeveel van de gemengde oplossing u uit de injectieflacon opzuigt, zoals verteld door uw arts of verpleegkundige.
- Als er op enig moment teveel lucht in de spuit zit, spuit de lucht dan terug in de injectieflacon.
- Tik zachtjes op de spuit, terwijl u de injectieflacon ondersteboven houdt, zodat eventuele luchtbelletjes naar boven gaan.
- Duw de zuigerstang langzaam in totdat alle luchtbelletjes verdwenen zijn.

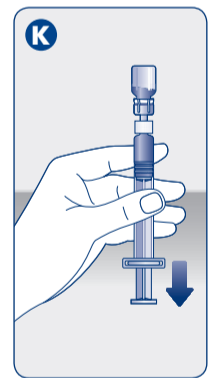

- Houd de zuigerstang ingedrukt en draai de injectieflacon rustig rond tot alle poeder is opgelost.
- Schud de injectieflacon niet omdat dit schuimvorming veroorzaakt.
- Controleer de gemengde oplossing. Deze moet kleurloos tot licht opaalachtig (licht ondoorzichtig) zijn.
- Als u zichtbare deeltjes of verkleuring ziet mag u de oplossing niet gebruiken. Gebruik dan een nieuwe verpakking.



- Schroef de injectieflaconadapter met de injectieflacon los.
- Raak de spuitpunt niet aan. Als u de spuitpunt aanraakt, kunnen ziektekiemen van uw vingers worden overgedragen.



Het wordt aangeraden om NovoEight® onmiddellijk te gebruiken nadat het gemengd is. Dit is omdat als het bewaard blijft, het geneesmiddel misschien niet meer steriel is en infecties kan veroorzaken. Als u de gemengde NovoEight®-oplossing niet onmiddellijk kunt gebruiken, moet deze binnen 4 uur worden gebruikt wanneer deze bewaard is geweest tot 30°C of binnen 24 uur wanneer het bewaard is geweest bij 2°C - 8°C. Bewaar het gemengde geneesmiddel in de injectieflacon. De gemengde NovoEight®-oplossing niet in de vriezer en niet in de spuiten bewaren. Bewaar de oplossing niet zonder advies van uw arts. Bewaar gemengd NovoEight® niet in direct licht.

- Als u een hogere dosis nodig heeft dan in 1 injectieflacon zit, herhaal dan stappen A tot en met J met extra injectieflacons, injectieflaconadapters en voorgevulde spuiten totdat u de benodigde dosis heeft.

5 Inspuiten van de gemengde oplossing

NovoEight® is nu klaar om in uw ader te worden ingespoten.

- Spuit de gemengde oplossing in zoals verteld door uw arts of verpleegkundige.
- Spuit langzaam in, gedurende 2 tot 5 minuten.
- Meng NovoEight® niet met andere intraveneuze infusies of geneesmiddelen.

De oplossing inspuiten via een centraal veneuze katheter of een onderhuidse poort:

- Gebruik een schone en ziektekiemvrije (aseptische) werkwijze. Vraag uw arts of verpleegkundige om specifieke aanwijzingen.
- Als de slang voor of na de NovoEight®-injectie moet worden gespoeld, gebruik dan 9 mg/ml natriumchloride-oplossing voor injectie.

Weggooiën

Gooi, na toediening, alle ongebruikte NovoEight®-oplossing, de spuit met de infusieset, de injectieflacon met de injectieflaconadapter en andere afvalmaterialen op een veilige manier weg zoals verteld door uw apotheker. Gooi het niet weg met het huishoudelijk afval.

Haal het materiaal niet uit elkaar voordat u het weggooit.

Gebruik het materiaal niet opnieuw.

Novo Nordisk B.V.

Flemingweg 18
2408 AV Alphen aan den Rijn
T +31 (0)172 44 96 00
informatie@novonordisk.com

www.novonordisk.nl
changing possibilities in haemophilia

changing possibilities
in haemophilia

